

# 中药学院对药剂学部等科研实验室开展安全检查

[2021]184

2022 1 6

C2

C524

C322

C325 326

SOP



SOP

C336

2

C524

[2021]184

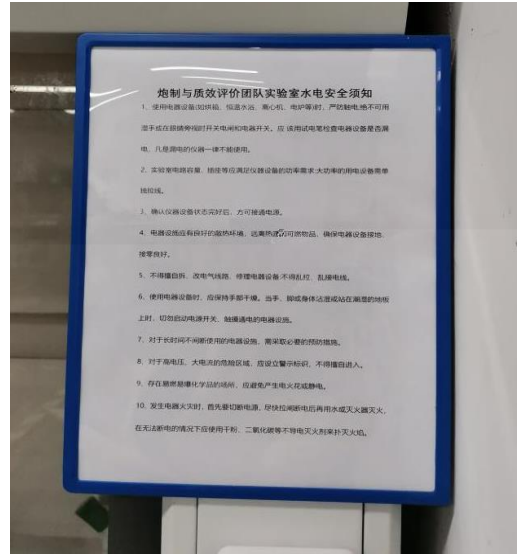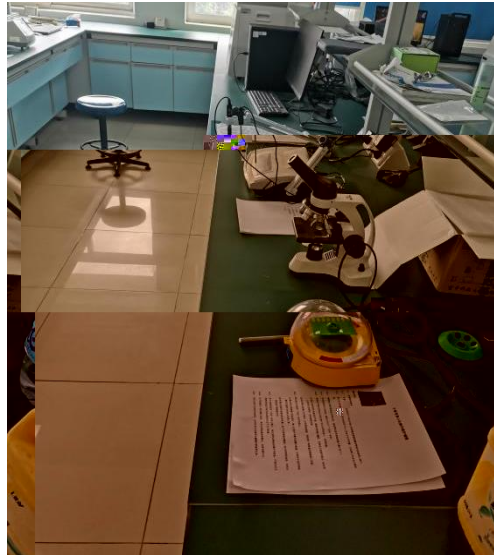


C322

SOP

C326

**炮制与质评价团队实验室水电安全须知**

1. 使用电器设备加药品、试剂时，应专心、谨慎，切勿嬉戏，严禁带电不可用手或身体接触任何开关电路和带电开关，应先用试电笔检查电器设备是否带电，凡带电的仪器一律不得使用。
2. 实验室电路复杂，额定电压与仪器设备的功率需求大功率的用电设备单独接地线。
3. 确认仪器设备状态完好后，方可接通电源。
4. 电器设备应有良好的散热环境，远离易燃易爆物品，确保电器设备接地线完好。
5. 不得擅自拆、改电气线路，修理电器设备不得乱拉、乱接电线。
6. 使用电器设备时，应保持手部干燥，当手、脚或身体沾湿或站在潮湿的地面上时，切勿启动电源开关，触摸通电的电路设施。
7. 对于长时间不间断使用的电路设施，需采取必要的防静电措施。
8. 对于高电压、大电流的危险区域，应设立警示标识，不得擅自进入。
9. 存在易燃易爆化学品的场所，应避免产生电火花或静电。
10. 发生电路火灾时，首先切断电源，尽快拉闸断电后再用水或灭火器灭火，在无法断电的情况下不得使用干粉、二氧化碳等不导电灭火器扑灭火灾。

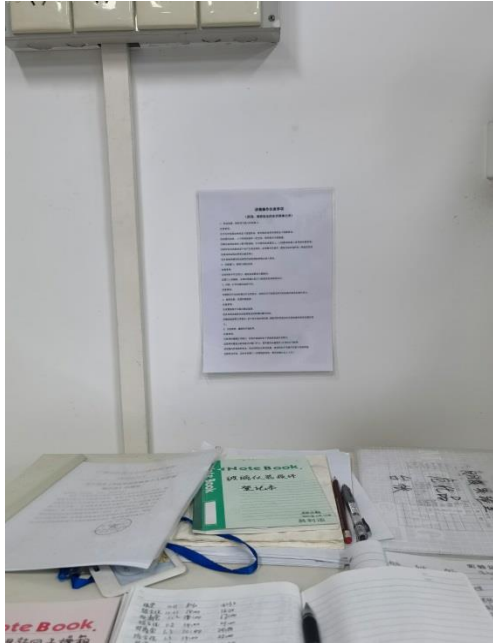

C326

SOP



C323



C328



C332